

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 200225079

 防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: UWXQ-7501-54


共3页 第1页



委托单位	江西浣星谷科技有限公司 地址: 江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭西区国际建材城华东11栋135号		
客户认定信息	功能性PTFE纳米纤维布 1卷		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-07-22
		报告签发日期	2020-07-31
判定依据	YY 0469-2011 《医用外科口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY 0469-2011	符合
	颗粒过滤效率	YY 0469-2011	符合
备注	原材料测试, 客户要求按YY 0469-2011 《医用外科口罩》检测和判定。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 郭子山 高级工程师




样品图片

(电子版)

No:200225079

共3页 第2页

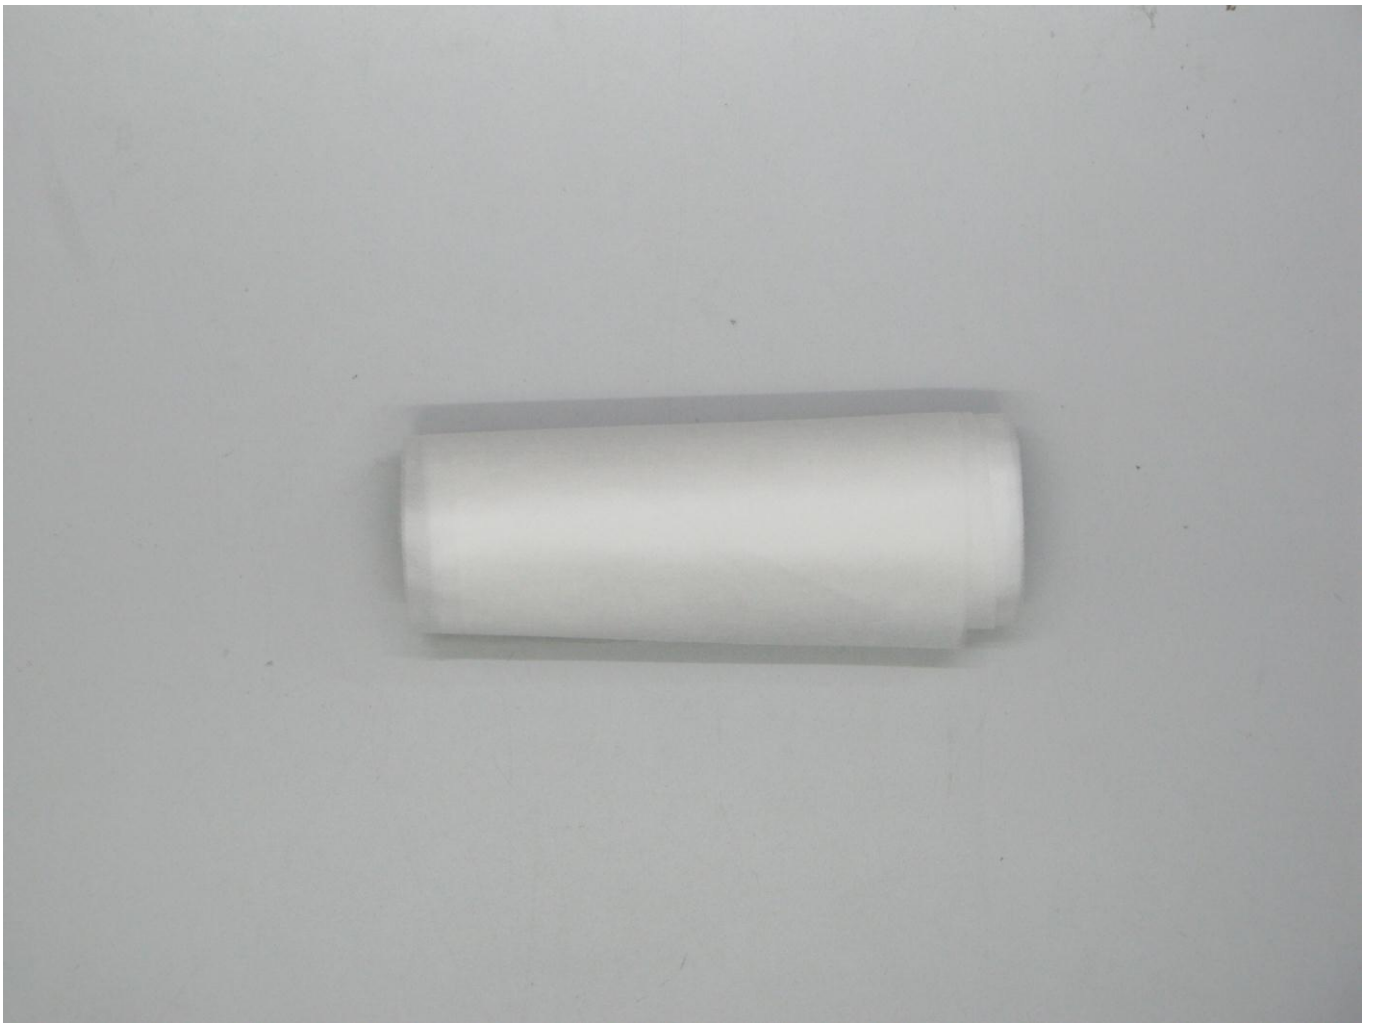

检验检测报告附页 (电子版)

No: 200225079

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 49cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 99.4 BFE ₂ 99.1 BFE ₃ 98.5	符合	
●颗粒过滤效率 (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量: 30L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m ³ 温度: 23.4℃ 相对湿度: 36.1%	≥30	最小值 97.56	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——